

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
10.05.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KARYOLA BAŞI SERUM ASKILIKLARI (MUKA MARKA HASTA YATAĞINA UYUMLU)	20 ADET	
2	KARYOLA BAŞI SERUM ASKILIKLARI (DOLSAN MARKA HASTA YATAĞINA UYUMLU)	5 ADET	
3	KARYOLA BAŞI SERUM ASKILIKLARI (MEDİKAL MARKA HASTA YATAĞINA UYUMLU)	2 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	BİLGİ İÇİN : 0352 207 66 66 , 20090 KAYNAK ATÖLYESİ		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		




NOT: Teklif mektuplarının en geç **23/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

SERUM ASKILIĞI ÖZELLİKLERİ

Servisimizde kullanılan hasta yatakların baş kısımlarında kullanılan sabit serum askılıklarının:

1. Serum askılıkları yükseklik ayarlı olmalıdır.
2. Metal kısmı Krom-Nikel 304 kalite malzemeden olmalıdır.
3. Serum askılıkları dört adet kollu olmalı ve her biri 1000 gr ağırlığı kaldırabilecek nitelikte olmalıdır.
4. Serum askılığı üst kısmı S şeklinde bükülmüş konum verme özelliğinde olmalıdır.
5. Serum askılıkları markasına uygun plastik yuvası olmalıdır.

Not: serum askılıkları beyaz renkte olmalıdır.

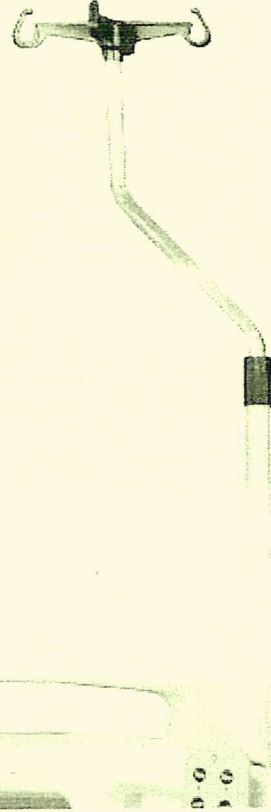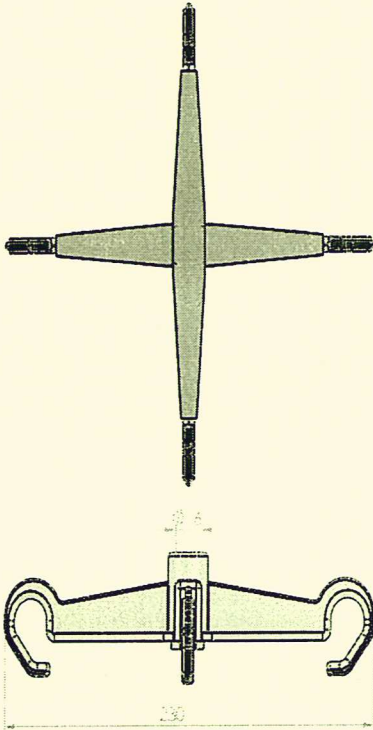

[Handwritten signature]

Ali CAĞMAZ
Tebrikat

Prof. Dr. İnci GÜLMEZ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 412
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD.

Prof. Dr. Nuri TUTAR
Dip. Tes. No: 118924
Uzm. Tes. No: 82517
Göğüs Hastalıkları A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri