



NOT : Teklif mektuplarının en geç **23/09/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI KROM-NİKRL RAF TEKNİK ŞARTNAMESİ

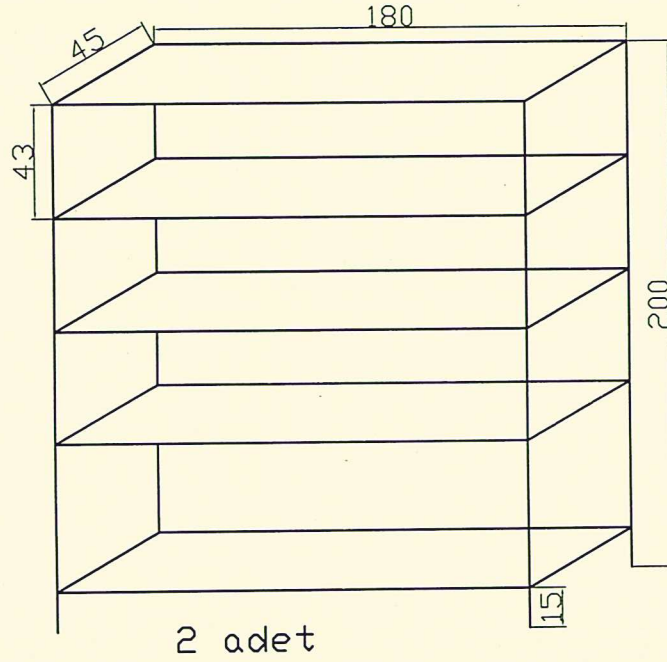

→ 2 Adet

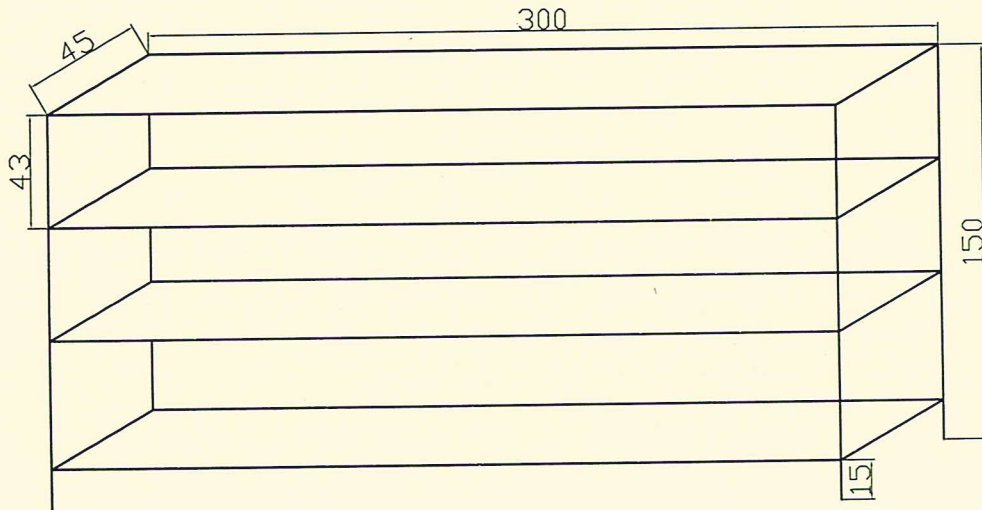

→ 1 Adet

- A. Rafların imalatı 304 kalite CrNi malzemeden yapılmış olacaktır.
- B. Rafların ayak kısımları 30x30x1 mm profilden olmalıdır.
- C. Rafların üst kısımları 0.75 mm sacdan olmalıdır.
- D. Raflardaki Malzemelerin kayıp düşmemesi için sac kısımlar profilin alt kısımlarına montaj edilmeli ve kesmeye karşı rodajlanmalıdır.
- E. Raf ayaklarına ayarlanabilir pabuç olmalıdır.
- F. Birleştirmeler kaynaklı olmalı ve kaykan yerleri parlatılmalıdır.
- G. Çizilen proje avam projesidir, imalatın net ve sağlıklı olması için ölçü yerinde alınmalıdır.

ERÜ SAĞLIK VE İLAHİYE ARASTIRMA MERKEZİ
M. CAYMAZ
Metal Teknoloji Teknisyeni
4554