



NOT: Teklif mektuplarının en geç **19/12/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

DAHİLİYE YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ KROM-NİKEL DOLAP TEKNİK ÇİZİMİ

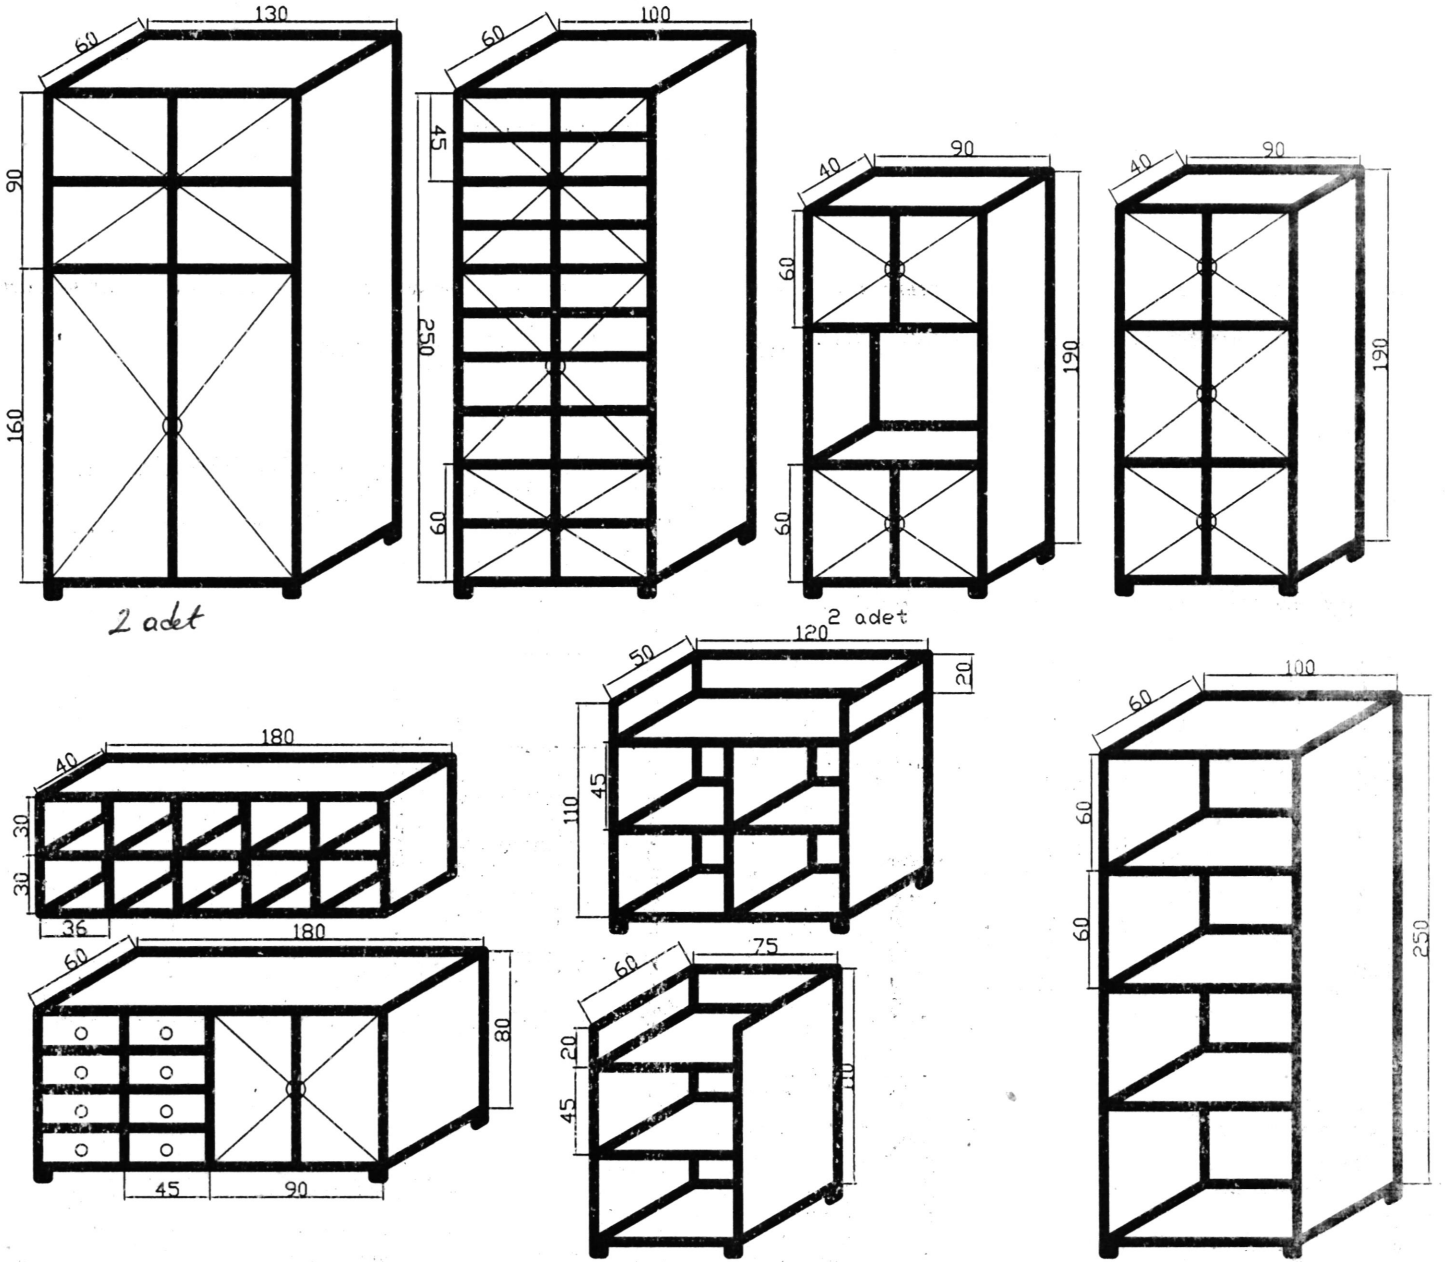

- A. Dolabın imalatı 304 kalite CrNi malzemeden yapılmış olacaktır.
- B. Dolabın dış kısmı sac kalınlığı 0.5 mm rafları ise 0.75 mm kalınlığında olmalıdır.
- C. Dolabın ayak kısmı 40x40x2 mm kutu profilden olacaktır. Ayak kısımlarında içten geçmeli ve ayarlanabilir pabuçlar olmalıdır.
- D. **RAFLAR YÜKSEKLİK AYARLANABİLİR OLMALIDIR.** Dolap yan kenarları ve raf ön kısımları personelin elini kesmemesi için kentsiz olmalıdır.
- E. Dolap kapaklarında ay kol tabir edilen kapak kolundan olmalıdır.
- F. Dolaplar düşme veya devrilmeye karşı duvara tespitlenmelidir.
- G. Birleştirmeler kaynaklı olmalı ve kaykan yerleri parlatılmalıdır.
- H. Çizilen proje avam projesidir, imalatın net ve sağlıklı olması için ölçü yerinde alınmalıdır.

DAHİLİYE YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ KROM-NİKEL DOLAP TEKNİK ÇİZİMİ

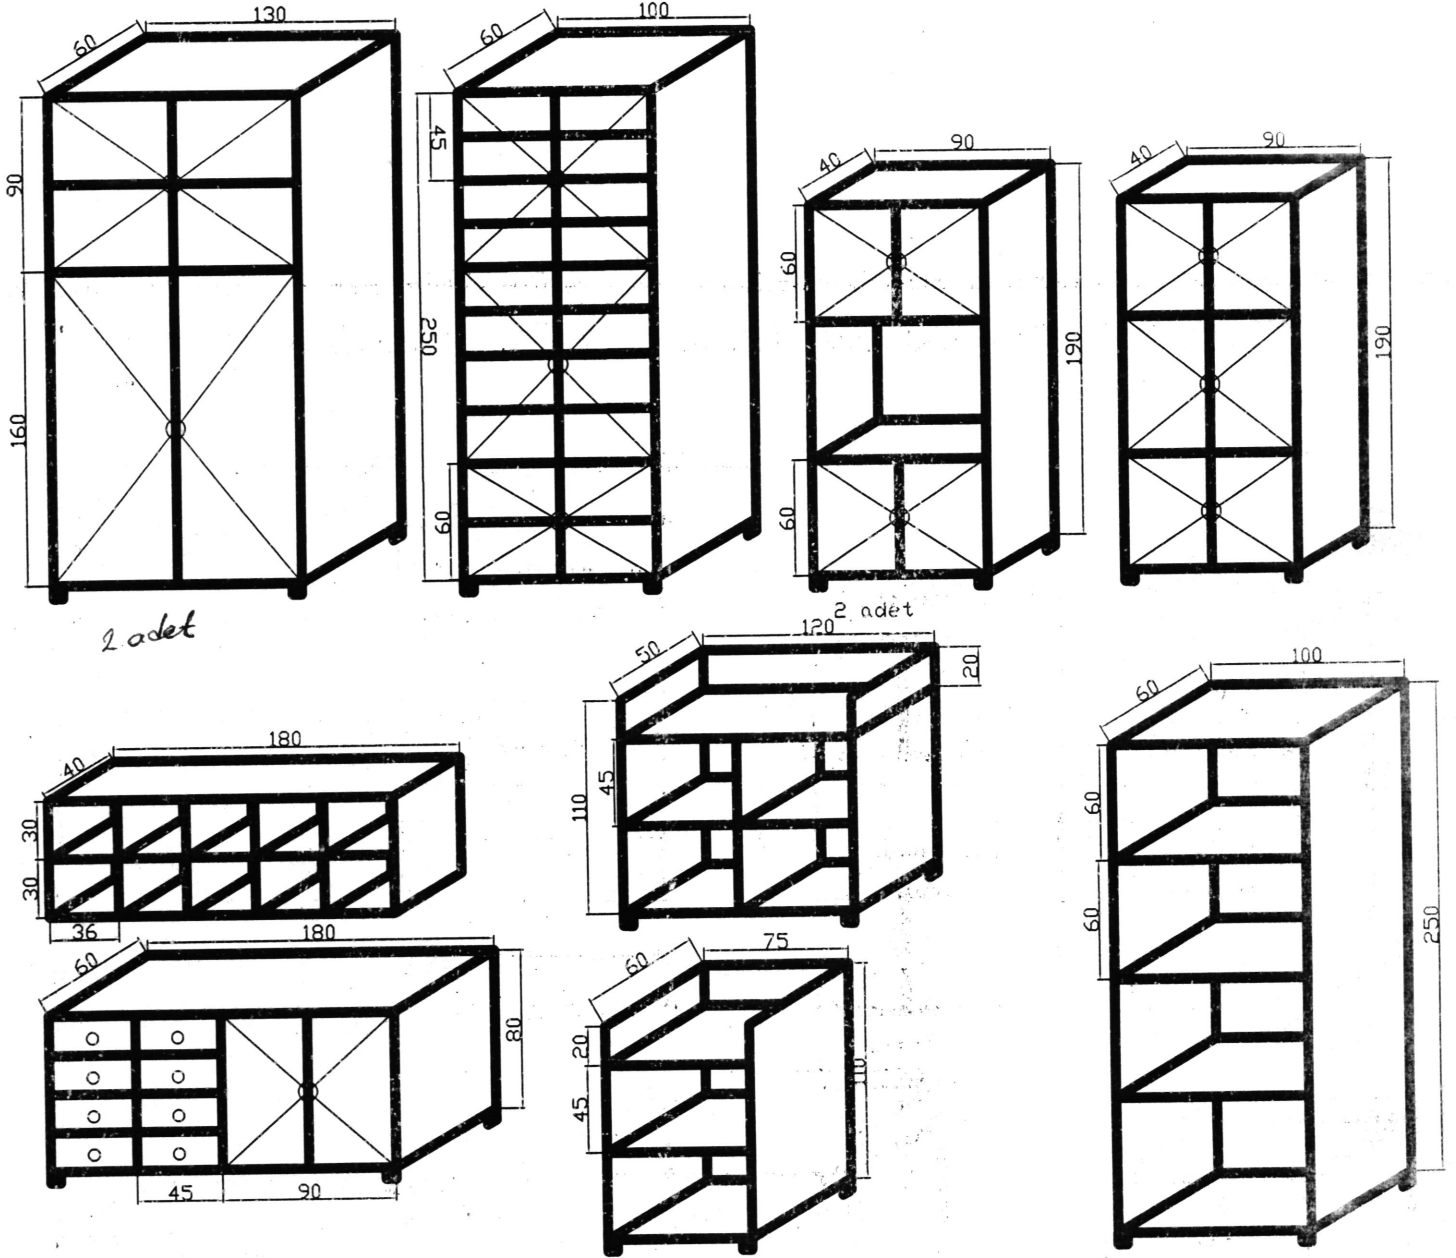

- Dolabın imalatı 304 kalite CrNi malzemeden yapılmış olacaktır.
- Dolabın dış kısmı sac kalınlığı: 0.5 mm rafları ise 0.75 mm kalınlığında olmalıdır.
- Dolabın ayak kısmı 40x40x2 mm kutu profilden olacaktır. Ayak kısımlarında içten geçmeli ve ayarlanabilir pabuçlar olmalıdır.
- RAFLAR YÜKSEKLİK AYARLANABİLİR OLMALIDIR.** Dolap yan kenarları ve raf ön kısımları personelin elini kesmemesi için kentsiz olmalıdır.
- Dolap kapaklarında ay kol tabir edilen kapak kolundan olmalıdır.
- Dolaplar düşme veya devrilmeye karşı duvara tespitlenmelidir.
- Birleştirmeler kaynaklı olmalı ve kaykan yerleri parlatılmalıdır.
- Çizilen proje avam projesidir, imalatın net ve sağlıklı olması için ölçü yerinde alınmalıdır.